


编号: YNH/AJ-15-33-2016

## 试剂出厂检验报告

试剂名称: NCH 清洗液  
 检验日期: 2026.03.21

试剂批号: 2260319  
 试剂规格: 40 型 (R1:40ml×4, R2:10ml×4)

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标示值。	R1:41.0ml R2:10.8ml	R1:41.0ml R2:11.0ml	R1:40.6ml R2:11.0ml	R1:40.9ml R2:10.9ml	√
pH 值	SBD 清洗液: 25±1℃, pH≥12; NCH 清洗液: 25±1℃, pH=7.80±0.05; 血小板分析仪专用清洗液: 25±1℃, pH=7.00±0.50; HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: 25±1℃, pH=7.10±0.20。	检测温度: 25.0℃				√
		7.78	7.78	7.77	7.78	
空白值	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: WBC ≤ 0.3×10 <sup>9</sup> /L	—	—	—	—	—
	血小板分析仪专用清洗液: RBC ≤ 0.03 × 10 <sup>12</sup> /L	—	—	—	—	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: RBC ≤ 0.03 × 10 <sup>12</sup> /L	—	—	—	—	
	血小板分析仪专用清洗液: PLT ≤ 10 × 10 <sup>9</sup> /L	—	—	—	—	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: PLT ≤ 20 × 10 <sup>9</sup> /L	—	—	—	—	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: HGB ≤ 2g/L	—	—	—	—	
结论	检验是否合格。					

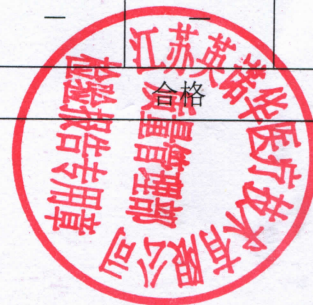

检验人: 周琦

复核人: 周琦

批准人: 周琦